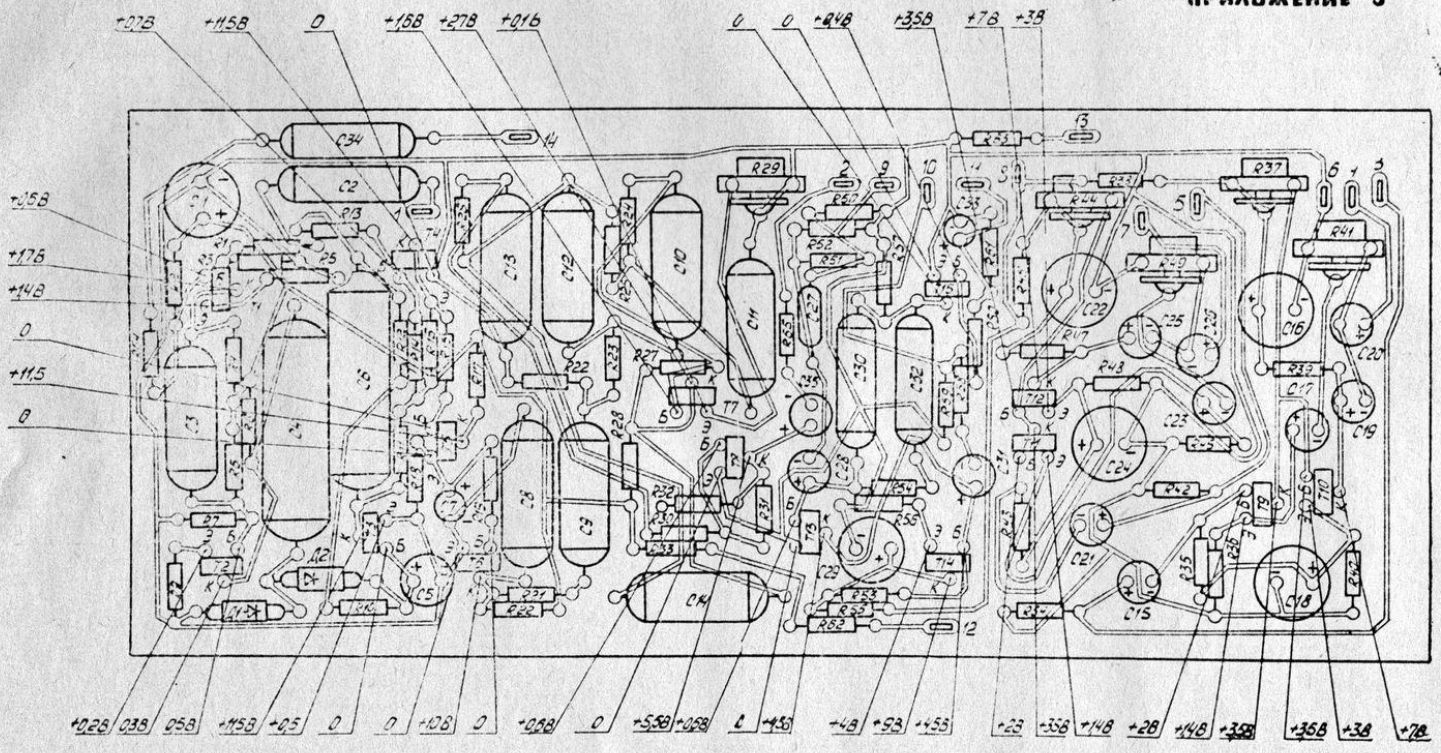

Рис. 18 Плата эффектов Э-1

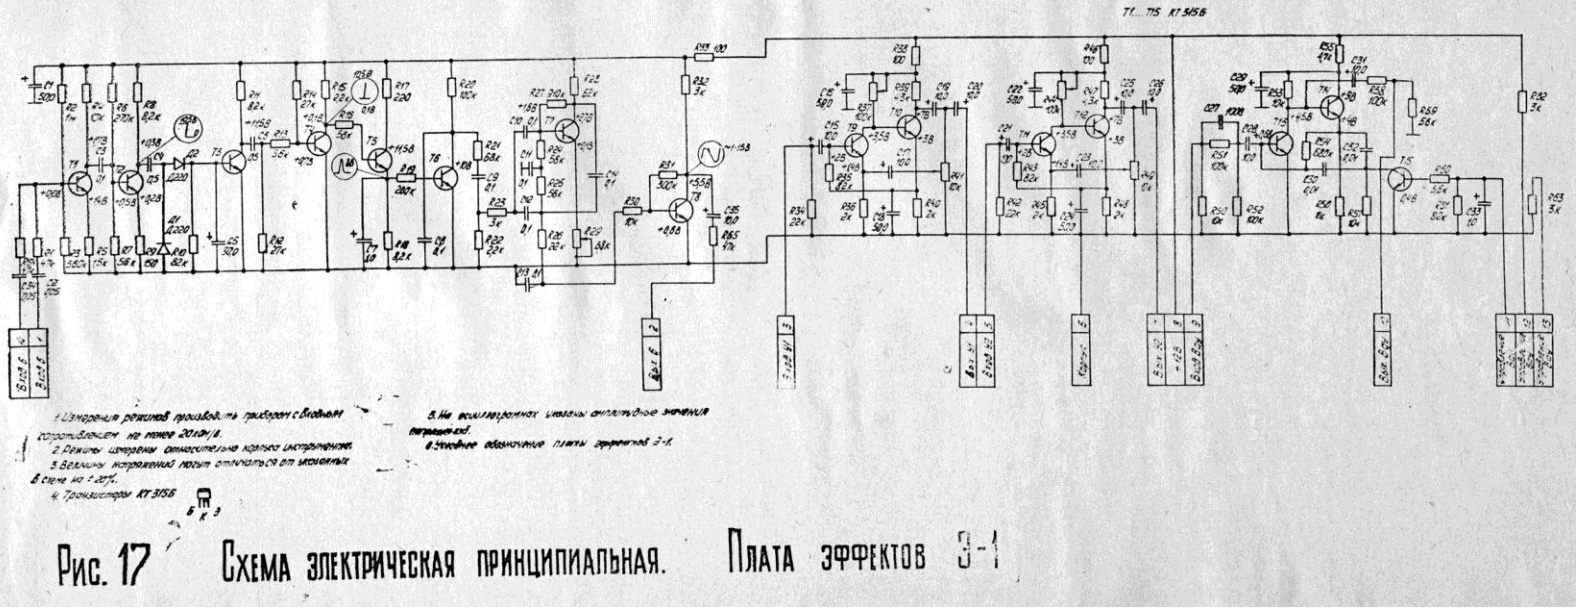

1. Измерения режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В.
2. Режимы измерены относительно корпуса инструмента.
3. Величины напряжения могут отличаться от указанных в схеме на ± 20%.
4. Транзисторы КТ 315Б

5. На осциллограммах указаны амплитудные значения напряжений.
6. Условные обозначения платы аналогичны Э-К.

Рис. 17 Схема электрическая принципиальная. Плата эффектов Э-1