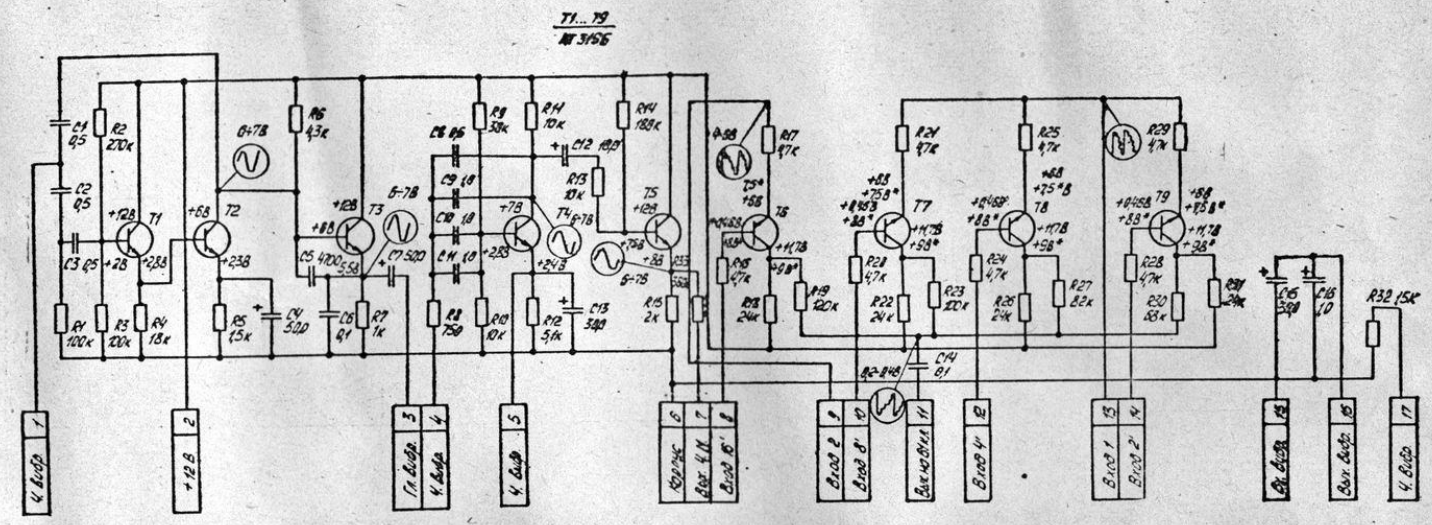

1. Измерения режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В.
2. Режимы могут отличаться от указанных в схеме на 20%.
3. Напряжения измеряются относительно корпуса инструмента.
4. Транзисторы КТ 315 Б



5. Напряжения, отмеченные (*) измерены при включении соответствующего регистра.
6. Условное обозначение платы Вибрато В-1.
7. На осциллограммах указаны амплитудные значения напряжений.
8. Коэффициент усиления транзисторов Т7 и Т9 должны быть не менее 200.

Рис. 15 Схема электрическая принципиальная. Плата вибрато В-1